

## 实验室用单支滤芯过滤器

# UD Type

### 用途


各种液体的实验室规模评估

少量生产

### 主要材质

设计耐压 : 0.49MPa  
 主要材质 : SUS304  
 内外表面处理 : 抛光 (#400)  
 液体损失量 : 84ml

\*液体损失量为敝司的计算值  
 根据内置滤材的类型, 数值可能会发生变动。

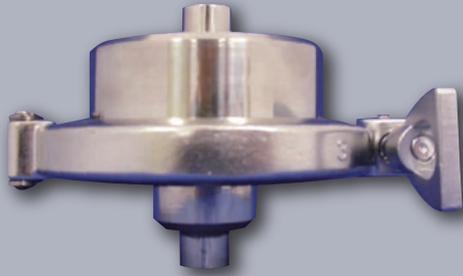

### 特 长

- 紧凑型设计
- 装卸部采用夹圈形式

### 优 势

- 减少液体损耗
- 适用于简易的过滤评估
- 不用工具即可拆卸

## 形 状

Code Y



## 对 应 滤 芯 型 号

全长

25L

25L = 25mm

滤芯型号

S H P - 0 2 0

\*请联系我们的销售代表, 了解各种滤芯的可用性。


滤芯 过滤精度

O型圈

E Y

S = Silicone  
 E = EPDM  
 N = NBR  
 V = FKM

## 构造

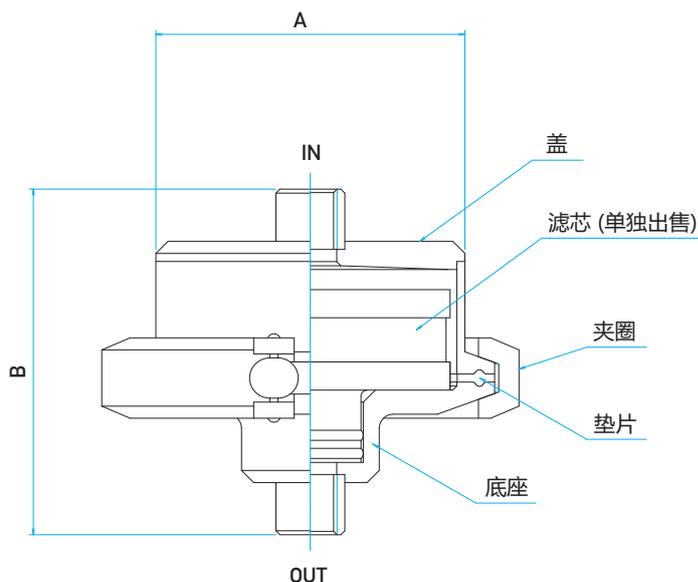

### 参数

安装滤芯的全长	25mm
安装滤芯的接口	Code Y (P-22 O-Ring)
盖	SUS304
夹圈	SCS13
垫片 ISO 35	NBR, EPDM, Silicone, FKM, PTFE Encapsulated
底座	SUS304
表面处理	内外表面抛光 (# 400)
设计耐压	0.49MPa at 40°C (71psi at 104°F)

\*也可以改变上述以外的材料、连接直径、连接形状等。详情请另行咨询。

### 尺寸

	A	B	接管口径
UD-25	76.3mm	86mm	G1/4

\*型录内容可能随时修正，敬请见谅。

\*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

\*购买过滤器外壳时，一定要检查过滤条件（流体、工作温度、工作压力、安装位置等）是否在外壳的规格范围内。

**ROKITECHNO MIRAI CO., LTD.**

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokechno.com

有关该公司及其技术的更多信息，请点击此处。



敝司制造与生产管理系统符合 ISO9001 认证。

认证范围

滤芯，过滤器及过滤设备的设计，开发，生产和销售。



7th Issue

UD220215CK